



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° 193986-101

Cliente: Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda.
Contato: Ney Apinhanese – ney.apinhanese@contemp.com.br
Alameda Araguaia, 204
09560-580 – Santa Maria – São Caetano do Sul – SP

Item: Multímetro digital tipo alicate

Referência: Pedido de compra n° 040601 de 22.11.2022

DESCRIÇÃO DO ITEM

Multímetro digital tipo alicate, marca Fluke, modelo 334, série n° 78705417 e identificação n° LALC-002.

Obs.: Registrado no LME sob n°(s) 1412/22.


INFORMAÇÕES PERTINENTES À CALIBRAÇÃO

1. Procedimento da calibração

Foi calibrada a faixa solicitada pelo cliente.

A execução da calibração foi baseada no(s) procedimento(s) interno(s) IPT4805 - G31 (Versão 9).

A calibração foi realizada pelo método de comparação com o(s) padrão(ões) utilizado(s), com frequência de 60 Hz e forma de onda senoidal.

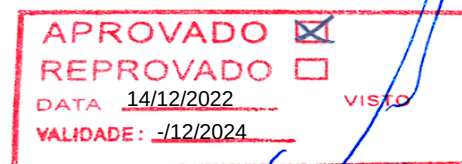

2. Incerteza

A incerteza expandida de medição relatada no item RESULTADOS é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com v_{eff} graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

3. Padrão(ões) utilizado(s)

Descrição	Modelo	Série N°	Certificado N°	Origem	Validade
Fonte padrão de tensão e corrente AC	2558	51AZ0020	188680-101	IPT-LME	jan./2023

4. Rastreabilidade

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida (ou ao Sistema Internacional de Unidades).

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
 Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
 A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Metrologia Elétrica / Tecnologias Regulatórias e Metrológicas
Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0047

Certificado de Calibração N° 193986-101

5. Condições durante a calibração

As medições foram realizadas na temperatura ambiente de $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa do ar de $(60 \pm 20) \%$, nas instalações permanentes do laboratório.

6. Legenda para as abreviações usadas na apresentação dos resultados

VI = Valor Indicado (indicação obtida no item sob calibração)

VR = Valor de Referência (indicação obtida no padrão)

Erro = VI – VR (erro de indicação do item sob calibração)

EMA = Erro Máximo Admissível (limites de erros especificados pelo fabricante do item sob calibração)

U = Incerteza Expandida de Medição

k = Fator de Abrangência (fator multiplicativo adimensional)

v_{eff} = Graus de liberdade efetivos


7. Data da execução da calibração: 09.12.2022.

Calibração executada por: Técnico Anderson Poiani Lopes Mendes

São Paulo, 09 de dezembro de 2022.

TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS
Laboratório de Metrologia Elétrica
Físico Regis Renato Dias
Pesquisador e Responsável pela Análise Crítica
RE nº 8825
Assinado digitalmente

TECNOLOGIAS REGULATÓRIAS E METROLÓGICAS
Laboratório de Metrologia Elétrica
Eng.º Eletricista Tomie Yokoji
Gerente Técnica e Responsável pela Autorização
RE nº 8176.0
Assinado digitalmente

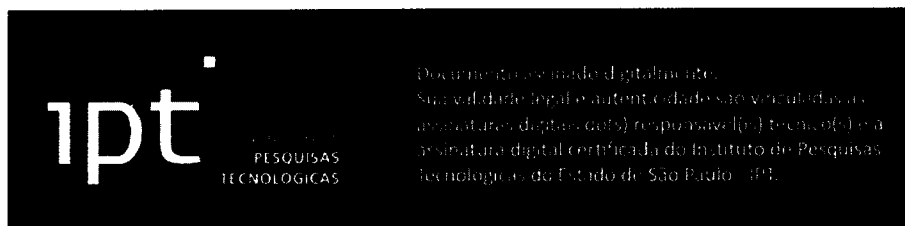

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Laboratório de Metrologia Elétrica / Tecnologias Regulatórias e Metrológicas
Laboratório de calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CAL 0047

Certificado de Calibração N° 193986-101

RESULTADOS

Faixa de 0 a 600 A AC (50 Hz/60 Hz)

Erro Máximo Admissível (EMA): $\pm 2\%$ do valor indicado + 5 dígitos

Unidade	VI	VR	Erro	EMA	U	k	V _{eff}
A	29,8	30,00	-0,20	1,1	0,11	2,09	30
A	75,2	75,00	0,20	2,0	0,10	2,00	∞
A	100,4	100,00	0,40	2,5	0,12	2,00	∞
A	301,3	300,00	1,30	6,5	0,63	2,00	∞
A	506,2	500,0	6,2	11	1,9	2,00	∞

----- Fim do Certificado de Calibração -----

Os resultados apresentados neste documento se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento não dá direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenização.
A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.