



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº MA 150_12_22




Solicitante:

Contemp Indústria Comércio e Serviços Ltda
Alameda Araguaia, 204 - São Caetano Sul / SP

Contratante:

O Mesmo
O Mesmo

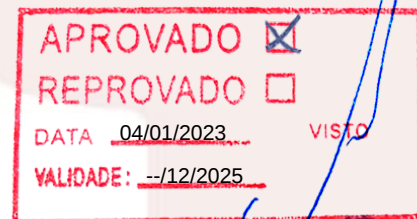

Objeto Calibrado: Peso Padrão 2 Peças

Descrição dos Objetos Calibrados	2 g e 10 g	Identificação do Conjunto	LPES-017
Nome do Fabricante	Não Consta	Número de Série	Não Consta
Classe Declarada	F1	Número do Processo	03361.7-12/2022
Data do Recebimento	08/12/2022	Data da Emissão	19/12/2022
Conferência	Gerente Técnico	Data da Calibração	16/12/2022
	 Erick A. de Souza	Técnico Executante	César Augusto

A calibração foi realizada por comparação direta com pesos de referência utilizando-se o método de dupla substituição 'ABBA', com pesos de referência de classe superior ao objeto medido, segundo a classificação da OIML R111-1 e portaria 233/94, conforme Instrução Técnica 022 do Manual da Qualidade da Padrão Balanças.

Rastreabilidade

Pesos Padrões Utilizados

Conjunto de Pesos Padrão, classe de exatidão E², Caixa 60, certificado nº MA 381_01_22, Micro Comparador de Massa: BAL 001, calibrado em 29/07/2022, certificado nº BA 084_07_22, emitido por Padrão Balanças, válido até 01/2023

Comparadores / Balanças Utilizadas

Termo-higrômetro

Termo-higrômetro, TH 011, Certificado de Calibração nº CAL 216133/22, emitido por CAL 0056, válido até 09/2023

Barômetro

Barômetro, BAR 000, Certificado de Calibração nº CAL 216135/22, emitido por CAL 0056, válido até 09/2023

Condições Ambientais Durante a Calibração:

Temperatura:	21,4 °C ± 1,5 °C	Umidade Relativa do Ar:	44,7 % ± 15 %	Pressão Atmosférica:	923 hPa ± 10 hPa	Massa Específica do Ar:	1,08 ± 0,0009 kg/m³
---------------------	------------------	--------------------------------	---------------	-----------------------------	------------------	--------------------------------	---------------------

