



ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.

Soluções em Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 238181/24  
ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Fl. 1/2

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

DATA DA CALIBRAÇÃO: 27/05/2024

DATA DA EMISSÃO DO CERTIFICADO: 28/05/2024

CLIENTE: CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA  
ENDERECO: AL ARAGUAIA 204 - SÃO CAETANO DO SUL/SP  
SOLICITANTE: O MESMO  
ENDERECO: O MESMO  
INSTRUMENTO: MANÔMETRO DIGITAL  
MODELO: ABSI DIG-100-Z  
Nº DE SÉRIE: 012912  
Nº DE IDENTIFICAÇÃO: LPID-038  
ORDEM DE SERVIÇO: 1975-24  
PROCEDIMENTO: ABSI - PSG - 005 (Rev.1);

FABRICANTE: ABSI  
FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 a 1000 mmca  
FAIXA CALIBRADA: 0 a 1000 mmca  
VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,1 mmca

PADRÕES UTILIZADOS: Balança de Pressão/Vacuo BAL - 2164/23 - ABSI (Validade 09/2028), com incerteza de  $\pm 0,007\%$ .CONDIÇÕES AMBIENTAIS: A calibração foi realizada nas instalações da ABSI com o instrumento na sua posição de utilização a uma temperatura de  $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  e umidade relativa de  $50\% \pm 20\%$  e gravidade local de  $9,7864384 \text{ m/s}^2$ . O instrumento permaneceu sobre pressão máxima de aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.

PRESSÃO DE REFERÊNCIA UNIDADES		PRESSÃO INDICADA mmca			
SI kPa	INSTR. mmca	PRIMEIRO CICLO		SEGUNDO CICLO	
		Carrego	Descarrego	Carrego	Descarrego
0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,49	50,0	49,9	49,9	49,9	49,9
0,98	100,0	100,1	100,1	100,0	100,1
1,47	150,0	150,2	150,2	150,1	150,2
1,96	200,0	200,2	200,2	200,1	200,1
2,45	250,0	250,3	250,2	250,1	250,1
2,94	300,0	300,3	300,2	300,2	300,1
3,43	350,0	350,3	350,2	350,2	350,1
3,92	400,0	400,2	400,2	400,1	400,2
4,41	450,0	450,2	450,2	450,2	450,1
4,90	500,0	500,2	500,2	500,2	500,2
9,81	1000,0	1000,3	1000,3	1000,2	1000,2

## CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO A AMPLITUDE DA FAIXA DE CALIBRAÇÃO: (%)

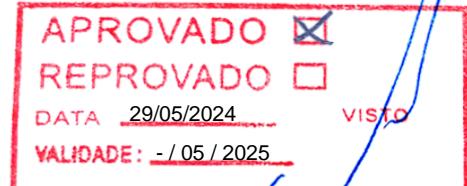
INCERTEZA DE MEDAÇÃO: 0,02 REPETIBILIDADE: 0,02

ERRO FIDUCIAL (ÍNDICE DA CLASSE): + 0,03 HISTERESE: 0,01

INCERTEZA DA CURVA: 0,065342 (mmca)

CURVA DE CALIBRAÇÃO:  $Y = -0,057396 + 0,999737 \cdot X$ 

COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO: 1,000000

Alessandro de Souza  
Gerente Técnico do LaboratórioAprovado digitalmente através da senha  
do usuário dia 28/05/2024 às 10:52hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.



ABSI SERVICE COM. DE INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP.

Soluções em Metrologia

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ABSI N° CAL - 238181/24  
ABSI LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO E ENSAIO

Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO / IEC 17025, sob o N° CAL 0056

Fl. 2/2



**OBSERVAÇÃO:**

- 1) 1 kPa =  $1,019716 \times 10^2$  mmca (kPa = quilopascal, unidade de pressão SI)
- 2) A validade do ensaio do instrumento deve ser estabelecida pelo usuário em plano de calibração descrito no sistema da qualidade de acordo com a norma NBR ISO 10.012 2004.
- 3) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência  $k = 2$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %. A Incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- 4) Pressão atmosférica em 27/05/2024 = 934,20 mbar

Alessandro de Souza  
Gerente Técnico do Laboratório

Aprovado digitalmente através da senha  
do usuário dia 28/05/2024 às 10:52hs.

Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela CGCRE que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

Os resultados apresentados no presente documento tem significação restrita e se aplicam somente ao instrumento calibrado. A utilização dos mesmos para fins promocionais depende de prévia autorização da ABSI. A reprodução do documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

Rua General Lecor, 979 - CEP 04213-021 - Fone: (11) 2273-1341 - Fone/Fax: (11) 2914-2233 - Ipiranga - São Paulo - SP  
C.N.P.J. 01.944.840/0001-75 - Inscrição Estadual 148.966.634.114 - e-mail: [absi@absi.com.br](mailto:absi@absi.com.br) - Home Page: [www.absi.com.br](http://www.absi.com.br)